


FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CODE GTIN
X520	DENTAIRE SONDE EXPLORATEUR FIG 17	3607310073242

VISUEL / DIMENSIONS

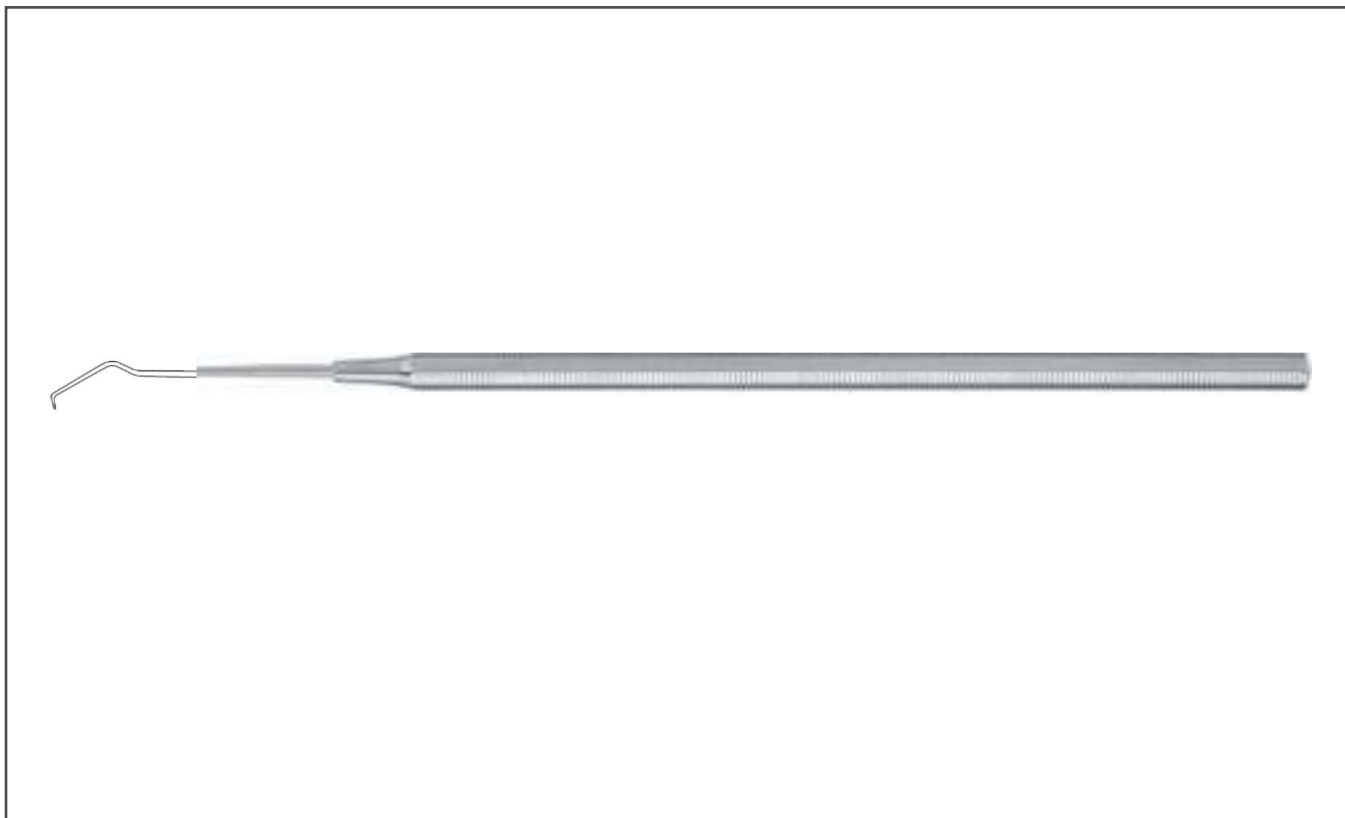

CLASSE : IR – INSTRUMENT DE CHIRURGIE RÉUTILISABLE NON STÉRILE

CARACTÉRISTIQUES : FINITION SATINÉE, MARQUAGE LASER SUR LE PLAT.

REVENDECATIONS / SPÉCIALITÉ CHIRURGICALE : DENTAIRE

MATÉRIAU / NUANCE : ACIER INOXYDABLE TYPE MARTENSITIQUE

NETTOYAGE / PRÉ-DÉSINFECTION : VOIR NOTICE STANDARD D'UTILISATION.

EMBALLAGE : SACHET SOUPLE SOUDÉ AVEC ÉTIQUETAGE PRODUIT.